



Magnétiseur Universel

Modèle déposé I N P I 2475



N. 026

Notice d'emploi

15.11.2019

1 Le Magnétiseur Universel M U doit être orienté au 333° rigoureusement contrôlé avec le cadran ° ou le pendule qui doit girer allègrement positif. Le M U doit être rendu immobile voir fixe au moyen de vis (trous préparés)

2 Il a été déterminé en recherche directe ou sur un tableau programmé fournit la puissance en magnet à afficher exemple 0.1 magnet

3 Régler la partie mobile sur + ou -15° et constater à l'aide du cadran de 0 magnet à 1 magnet que l'espace de soin vibre à 0 magnet.

4 Maintenant, en poussant la partie mobile doucement vers la gauche, le 0/360° vous surveillez sur le cadran que vous êtes bien réglé sur la puissance nécessaire au soin.

5 A l'aide du cadran effet minimum à maximum et à l'aide du pendule vous vous assurer que l'effet est bien au maximum.

6 Placer la photo de la personne à soigner, face dans l'encart défoncé prévu à cet effet, le haut de la tête vers le nord magnétique 333°. Vous aurez pris soin de vérifier le niveau de la personne sur C.000. Si celle-ci est chargée, il est nécessaire de la décharger avant de soigner.


7 A l'aide du syntoniseur, vous contrôler soigneusement l'avancement du soin. Au bout de quelques minutes les effets sont effectifs.

Nota : La puissance est très sensible suivant le réglage alors n'hésitez pas à recontrôler l'efficacité du soin par la précision de l'orientation adéquate.


Pour les maladies, le M U est très efficace.

Bernard Tenand


Zéro à 1 magnet

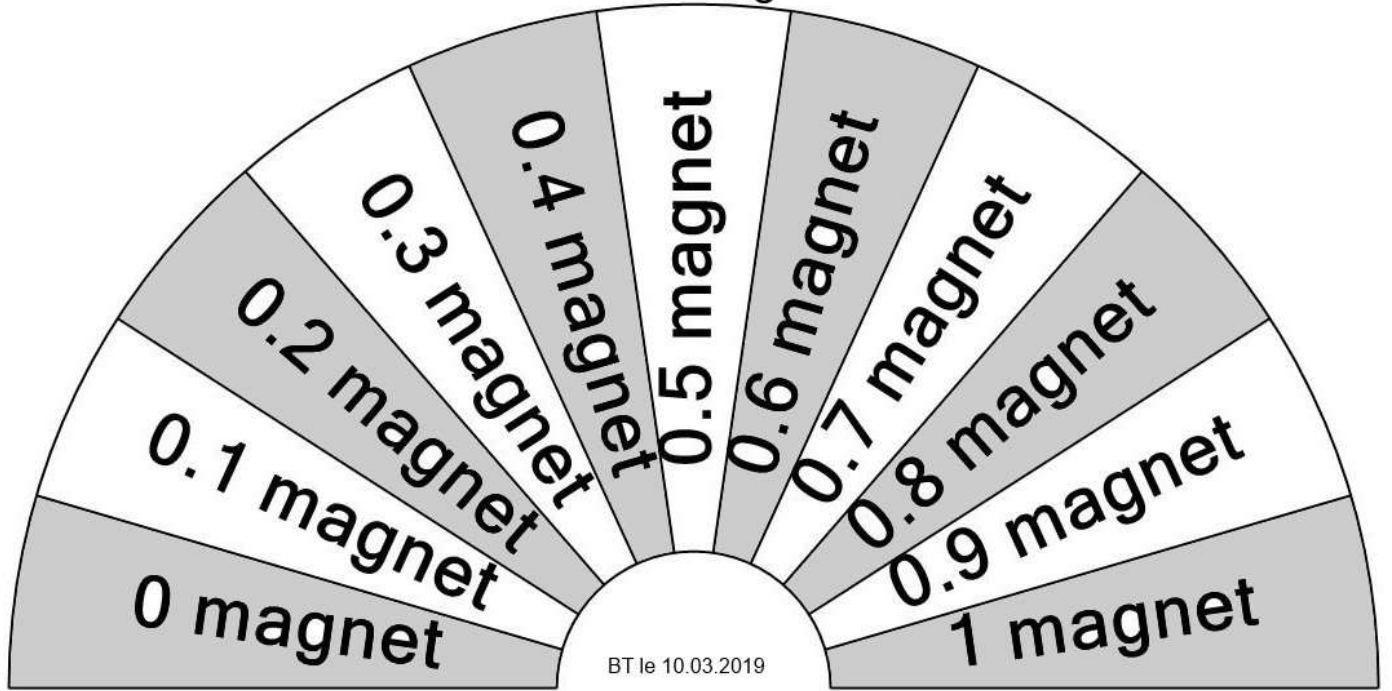

1.1 à 2 magnets

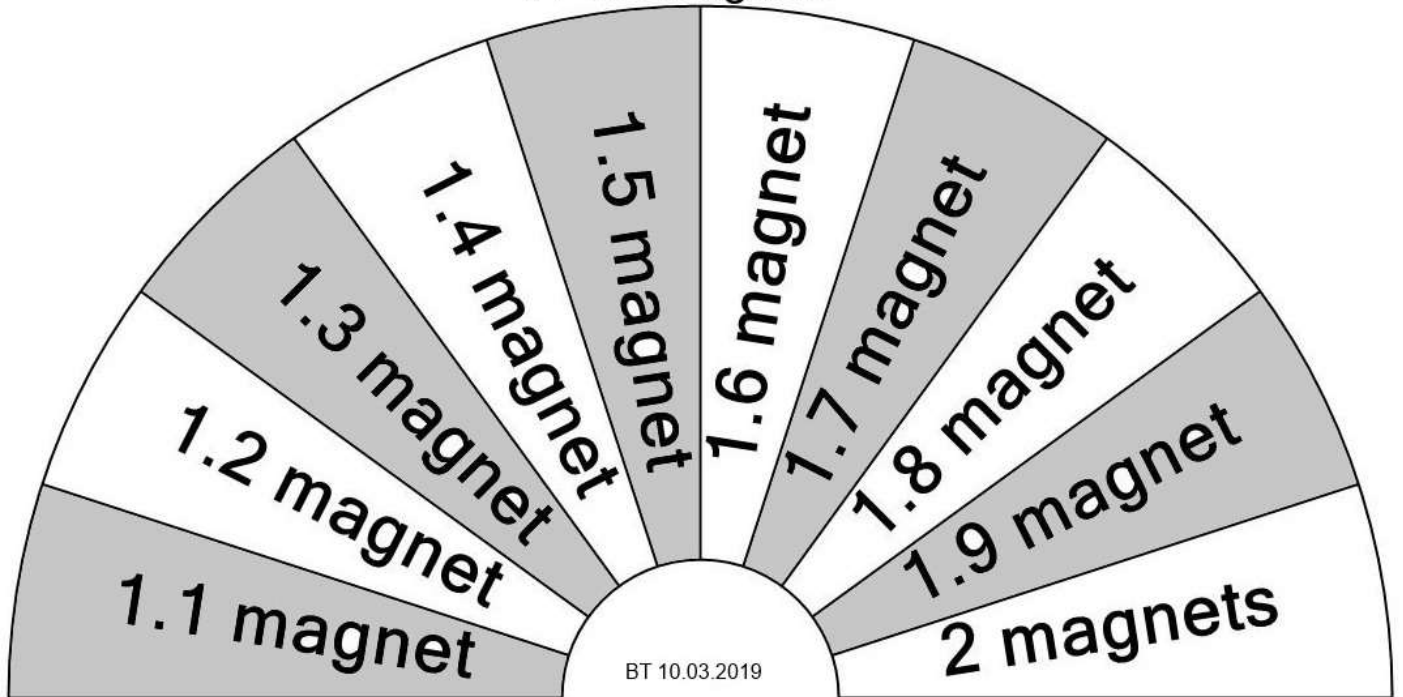

Recherche du nord magnétique

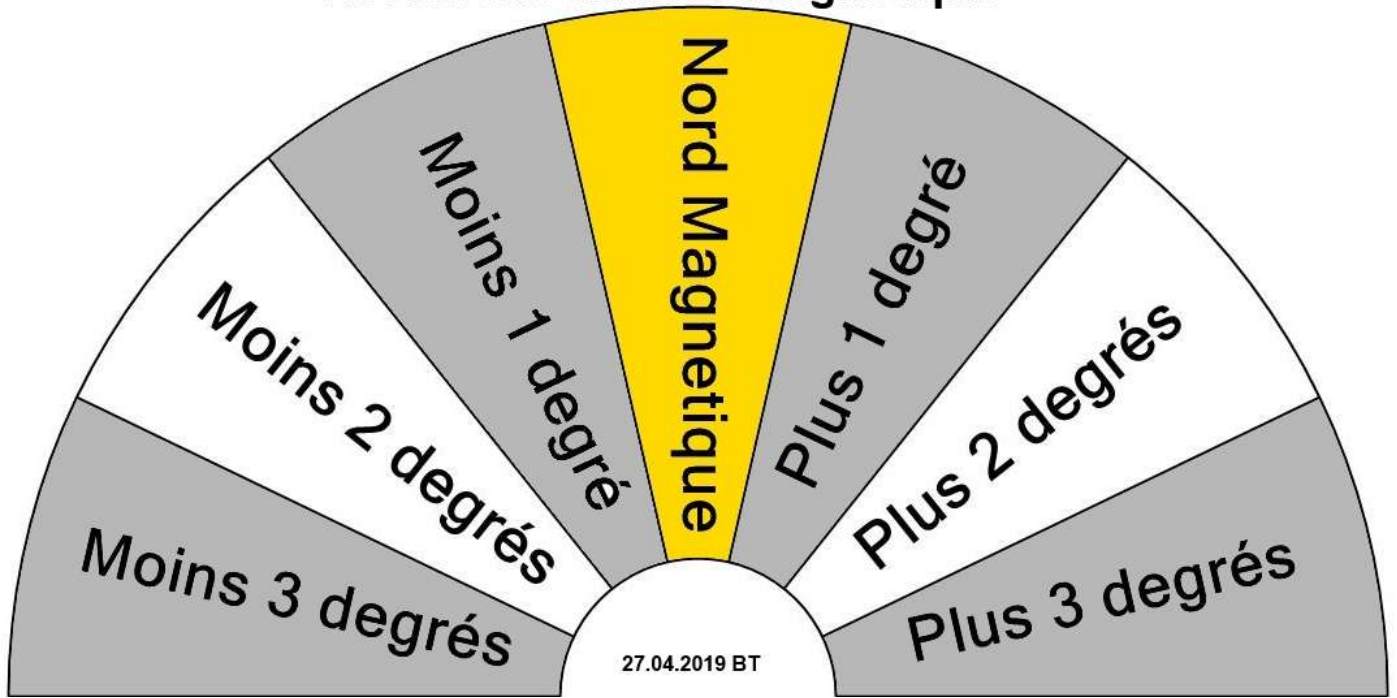

Efficacité du soin

